

PROČ ZÁPŮJČNÍ SÍTA?






Irena Jedonová

Centrální operační sály

FN Brno



COS - ORTOPEDIE

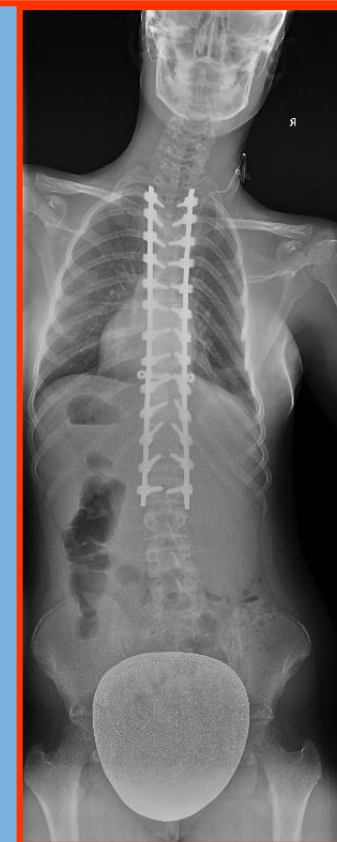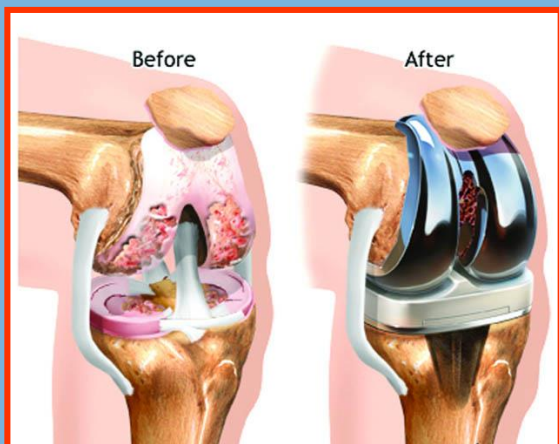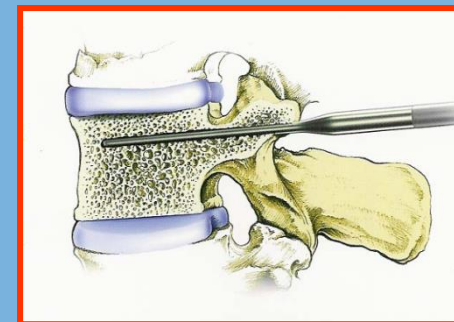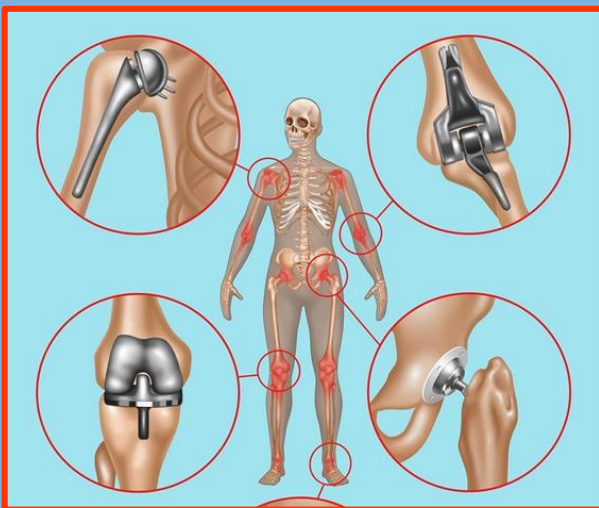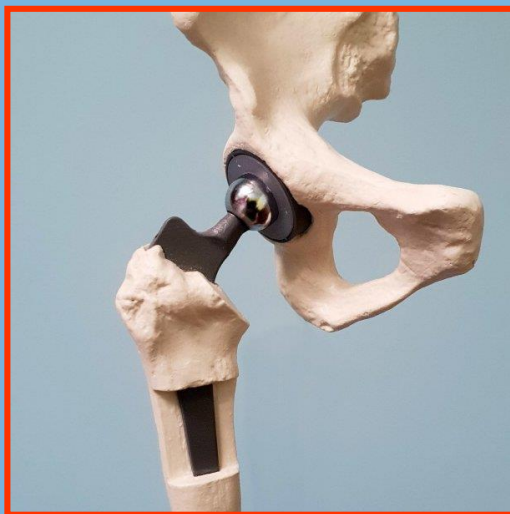

Proč

?

VS




?

ZS



?

CS


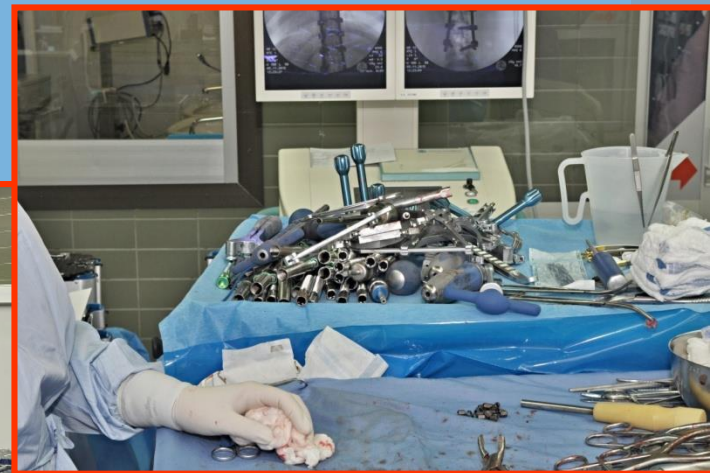


Kapacitní důvody

Okolo 30 systémů zavedeno v konsignačním skladu

- 10 typů TP
- 15 páteřní systémy
- 5 AS a jiných systémů
- cca 1850 Implantátů v KS + nástroje



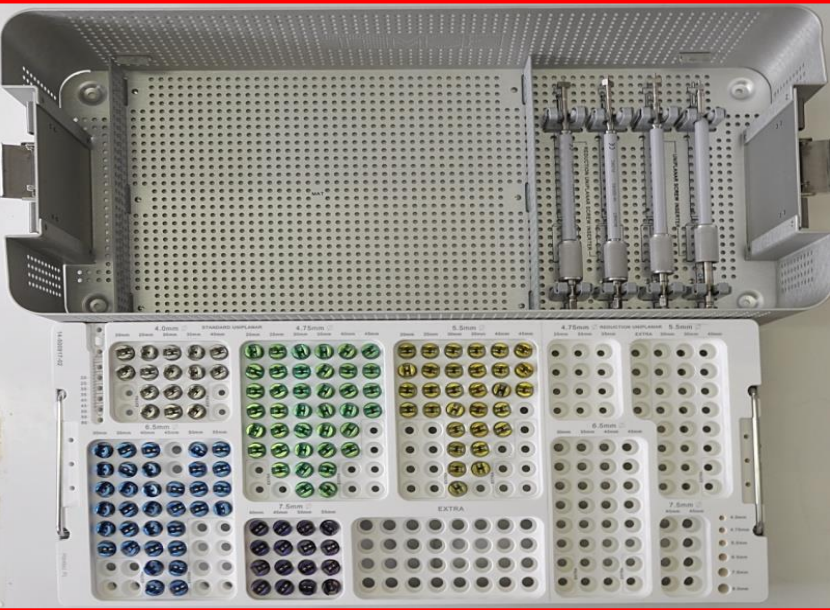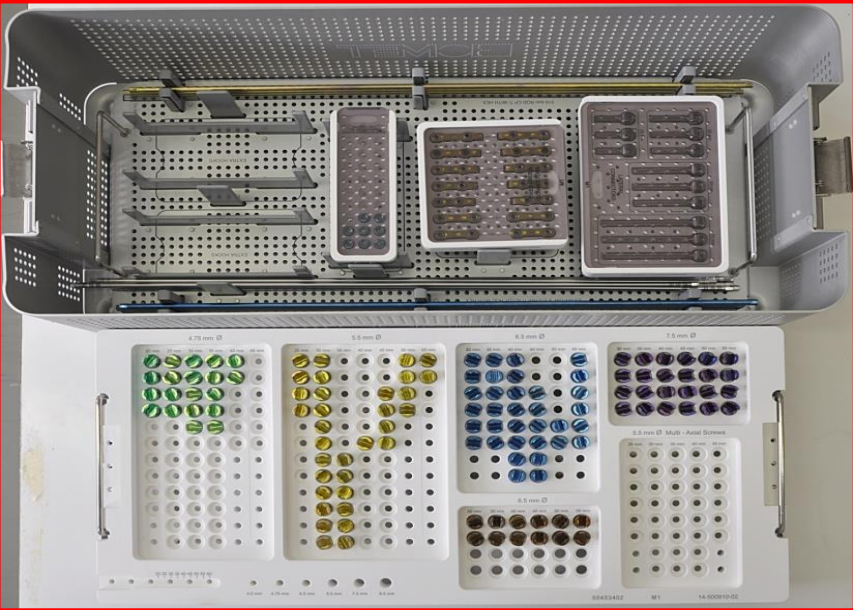


Frekvence použití

Finanční rentabilita

- Málo používaná síta – malý obrat
- Finanční hodnota obsahu



6.9. – 10.9. 2021 = 47 operací

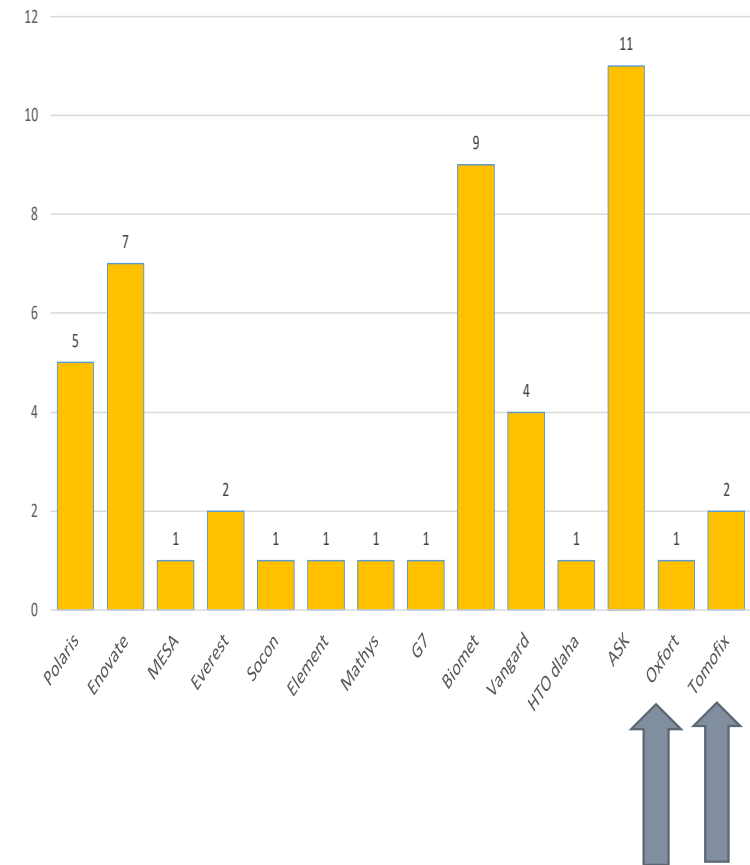

Revizní operace TP
Individuální TP
TP ramene
Speciální korekční osteotomie
RTG transparentí implantáty na páteř
A další málo frekventované výkony



Budoucí nový konsignační sklad

Výměna modernizovaných instrumentárii

Klinické studie



Nové přístroje a jejich příslušenství - vrtačky, pily a arthroskopické věže



Administrativní procesy spojené s použitím zápůjčních sít:

- na základě požadavku lékaře - oznámení o dodání zápůjčního sít
- seznam implantátů s VZP kódy
- seznam nástrojů, foto
- záznam do dokumentace pacienta



RK - LCCK + RHK + LPS plata + dříky s břity, TM Cony Tibial a Femoral - implantáty				
LCCK				
REF	Popis	VZP Kód	Počet	Použité položky
00-5150-482-01	PULS PLUS HIP KIT	nemá kód VZP	1	
00-5980-037-01	ST PRC TIB PLT SIZE 3	0072164	1	
00-5980-037-02	ST PRC TIB PLT SIZE 4	0072164	1	
00-5980-047-01	ST PRC TIB PLT SIZE 5	0072164	1	
00-5980-047-02	ST PRC TIB PLT SIZE 6	0072164	1	
00-5980-047-01	ST PRC TIB PLT SIZE 3	0072164	1	
00-5980-047-02	ST PRC TIB PLT SIZE 4	0072164	1	
00-5980-047-03	ST PRC TIB PLT SIZE 5	0072164	1	
00-5980-047-04	ST PRC TIB PLT SIZE 6	0072164	1	
00-5988-003-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ3	0005933	1	
00-5988-003-28	NG 15 TIB AUG RT LATLT MED SZ3	0005933	1	
00-5988-003-29	NG 20 TIB AUG RT LATLT MED SZ3	0005933	1	
00-5988-003-38	NG 15 TIB AUG BLK LLATRMED SZ3	0005933	1	
00-5988-003-39	NG 20 TIB AUG BLK LLATRMED SZ3	0005933	1	
00-5988-004-10	10 MM FULL BLOCK TIB AUG SZ 4	0031290	1	
00-5988-004-26	PRC TIB BLOCK 5MM SZ4	0005933	2	
00-5988-004-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ4	0005933	1	
00-5988-004-28	NG 15 TIB AUG RT LATLT MED SZ4	0005933	1	
00-5988-004-29	NG 20 TIB AUG RT LATLT MED SZ4	0005933	1	
00-5988-004-38	NG 15 TIB AUG BLK LLATRMED SZ4	0005933	1	
00-5988-004-39	NG 20 TIB AUG BLK LLATRMED SZ4	0005933	1	
00-5988-005-26	PRC TIB BLOCK 5MM SZ5	0005933	2	
00-5988-005-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ5	0005933	1	
00-5988-005-28	NG 15 TIB AUG RT LATLT MED SZ5	0005933	1	
00-5988-005-29	NG 20 TIB AUG RT LATLT MED SZ5	0005933	1	
00-5988-005-38	NG 15 TIB AUG BLK LLATRMED SZ5	0005933	1	
00-5988-005-39	NG 20 TIB AUG BLK LLATRMED SZ5	0005933	1	
00-5988-006-10	10 MM FULL BLOCK TIB AUG SZ 6	0031290	1	
00-5988-006-26	PRC TIB BLOCK 5MM SZ6	0005933	2	
00-5988-006-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ6	0005933	1	
00-5988-006-28	NG 15 TIB AUG RT LATLT MED SZ6	0005933	1	
00-5988-006-29	NG 20 TIB AUG RT LATLT MED SZ6	0005933	1	
00-5988-006-38	NG 15 TIB AUG BLK LLATRMED SZ6	0005933	1	
00-5988-006-39	NG 20 TIB AUG BLK LLATRMED SZ6	0005933	1	
00-5988-007-10	10 MM FULL BLOCK TIB AUG SZ 7	0031290	1	
00-5988-007-26	PRC TIB BLOCK 5MM SZ7	0005933	2	
00-5988-007-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ7	0005933	1	
00-5988-008-10	10 MM FULL BLOCK TIB AUG SZ 8	0031290	1	
00-5988-008-26	PRC TIB BLOCK 5MM SZ8	0005933	2	
00-5988-008-27	PRC TIB BLOCK 10MM SZ8	0005933	1	
00-5988-010-10	STEM IMPLANT 10MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-11	STEM IMPLANT 11MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-12	STEM IMPLANT 12MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-13	STEM IMPLANT 13MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-14	STEM IMPLANT 14MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-15	STEM IMPLANT 15MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-16	STEM IMPLANT 16MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-17	STEM IMPLANT 17MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-18	STEM IMPLANT 18MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-20	STEM IMPLANT 20MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-22	STEM IMPLANT 22MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-010-24	STEM IMPLANT 24MMDX145MM	0031367	1	
00-5988-011-12	STEM IMPLANT 12MMX200MM	0031367	1	
00-5988-011-13	STEM IMPLANT 13MMX200MM	0031367	1	
00-5988-011-14	STEM IMPLANT 14MMX200MM	0031367	1	
00-5988-011-15	STEM IMPLANT 15MMX200MM	0031367	1	
00-5988-011-16	STEM IMPLANT 16MMX200MM	0031367	1	

Administrativní procesy spojené s použitím zápůjčních sít:

Žádanka na parní sterilizaci

oddělení Centrální sterilizace					
Pracoviště, klient: COS ORT		Čas příjmu na CS:			
Nákl. středisko: 4783		Teplota sterilizace:		134 °C, 121 °C	
Čas dekontaminace do:		Statim: ☐ ano			
		Množství			Zabalili
Obal	Název ZP	žadané	kontr.	vydané	kontr. zam. CS
Vyhotovil:	Převzal:	Sterilizoval:	Ydal:	Přijal:	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	
Vysvětlivky k vyplnění:					
Obal: K - kontejner F - fólie 2xF - fólie dvojité L - celopapír. obal	Teplota sterilizace: / °C / dle doporučení výrobce zdravotnického prostředku	ZP - zdravotnický prostředek Název ZP : viz. smluvní seznam CS+klient			
5 - 039, 04 /					

- po operaci se vyplní spotřební formulář
- dekontaminační protokol
- objednávka do SZM
- kopie spotřeby pro firmu – doplnění implantátů
- požadavek na sterilizaci před a po operaci

[illegible]

Dodání zápůjčních sít

Různé firmy a společnosti – různá pravidla
a podmínky

Různé velikosti a obsah



Dodání zápůjčních sít

- V noci, minimálně jeden den před operací
- Během dne
- V den operace
- Zástupce firmy x Převážní společnost
- Sterilní x nesterilní
- S dokumentací – seznam nástrojů a implantátů, foto
- Bez dokumentace

Komplikace - nesprávný adresát, nedodržení čas
- špatně uložené, v nevhodných obalech
- nekompletní obsah



Příprava zápůjčních sít

Vybrat vhodný obal

Naskládat pro instrumentárku

Označit pro centrální sterilizaci



Příprava zápůjčních sít

Uložit do skladu



Použití zápůjčních sít - pomoc zástupce firmy



Závěr

Počet druhů i počet použití různých zápůjčních sít se zvyšuje

- Nároky na pozornost
- Nestandardní , neznámé nástroje
- Složitá instrumentária
- Malá frekvence použití jednotlivých typů – personál nezná
- Zpracování při běžném provozu
- Administrativní zátěž
- Zvýšená možnost komplikace
- Rizika při odvozu

Zápůjčným sítům se asi už nikdy nevyhneme. Vývoj v medicíně je stále rychlejší, i v jiných oborech, ale protože ortopedie a spondylochirurgie pracuje s velkým množstvím různých nástrojů a implantátů je jeden z nejtěžších oborů, ve smyslu obsahu a hmotnosti, proto bude zpracování zápůjčních sít patřit vždy k nejproblematičtějším.



Děkuji za pozornost

